ОДНОРАЗОВАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ

РЕТРАКТОРНАЯ СИСТЕМА

Microcure в колопроктологической хирургии

Стабильная ретракция тканей
Оптимальная экспозиция операционного поля

Материал для профессиональной хирургической аудитории

microcure

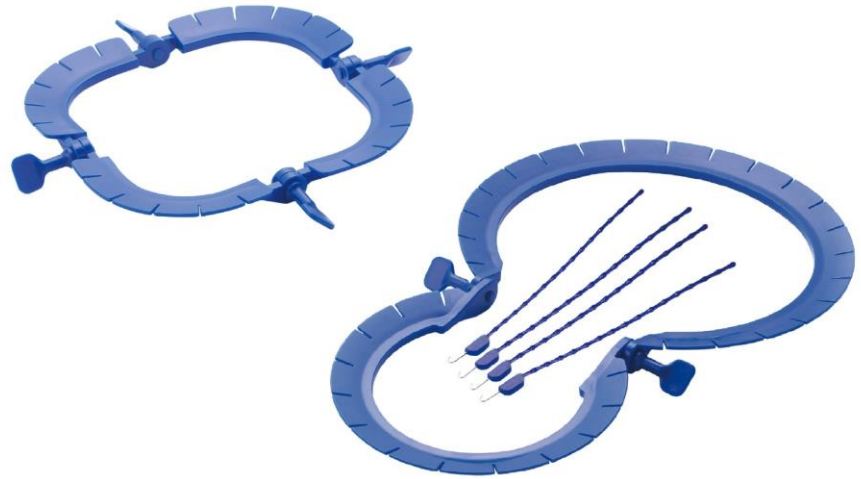

SURGERY RETRACTOR SYSTEM

The retractor system operates manually with self–locking function.It consists of a retractor ring,movable scnews and retractor hooks.

Product Description

Система и принцип работы

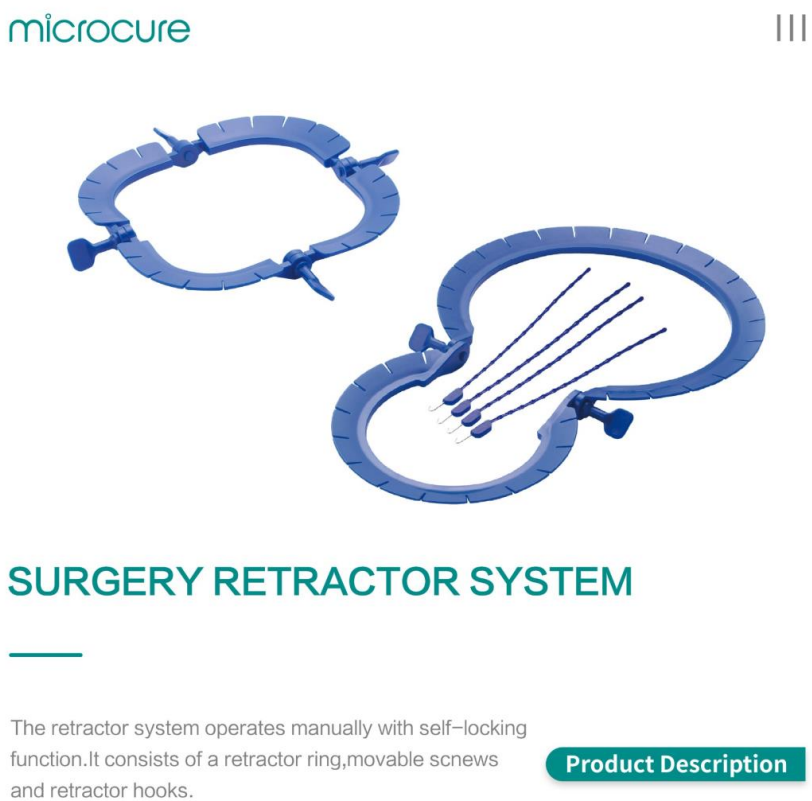

Ретракторное кольцо

размещается вокруг операционного доступа и служит опорой для фиксации крючков.

Ретракторные крючки

фиксируются одной стороной за край раны, другой — за ретракторное кольцо.

Эластическое натяжение

поддерживает стабильную ретракцию; направление натяжения отдельных крючков можно изменять по ходу вмешательства.

Возможности в колопроктологии

Акцент на формировании и поддержании операционного доступа

- **Стабильная экспозиция** поддержание раскрытия операционного поля без непрерывного ручного удержания тканей.
- **Распределённая ретракция** несколько независимых точек фиксации по окружности доступа.
- **Динамическая коррекция** отдельные крючки можно переставлять и менять направление натяжения.
- **Свободное центральное поле** ретракционные элементы фиксируются к кольцу за пределами рабочей зоны.

Клиническое применение

Пример установки ретракторной системы в аноректальной области

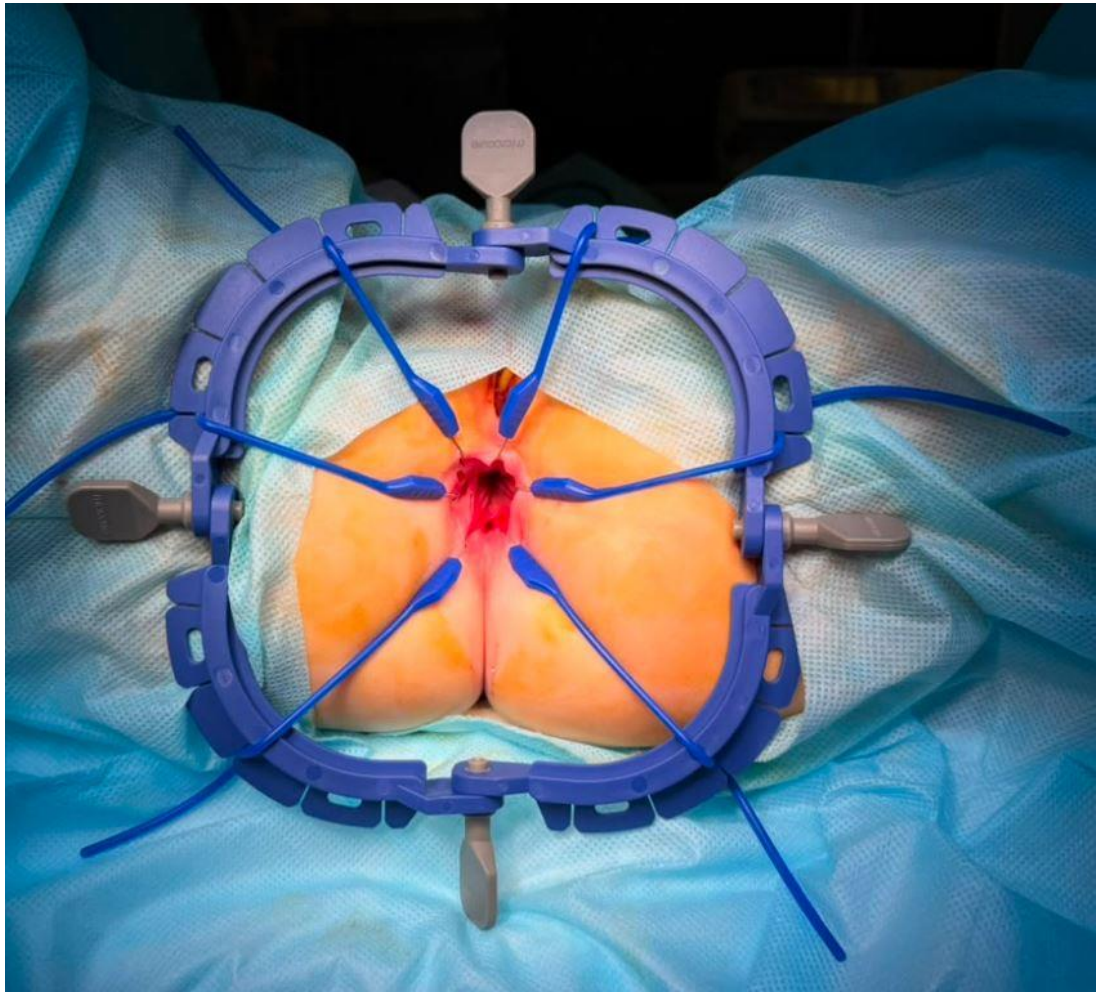

Независимые точки фиксации

Крючки распределяются по окружности и формируют направленную ретракцию тканей.

Стабильное операционное поле

Кольцо служит внешней опорой; рабочая зона остаётся в центре системы.

Клиническое фото предоставлено в рамках апробации системы.

Формирование операционного доступа

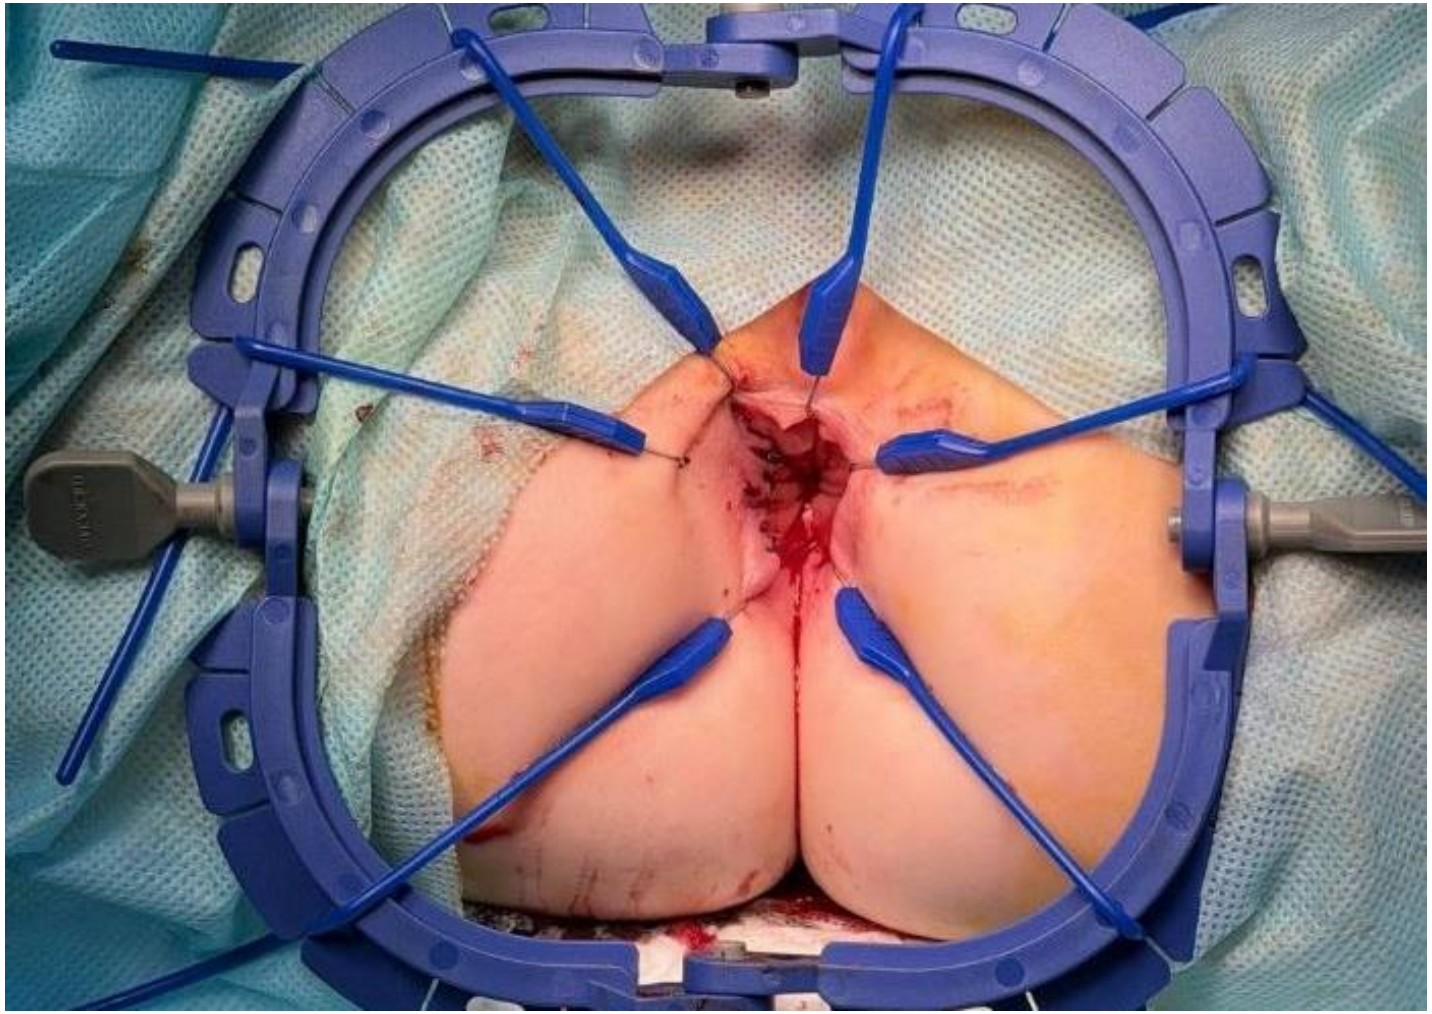

1 **Радиальное направление тракции**

Каждый крючок формирует отдельный вектор натяжения.

2 **Коррекция по этапу операции**

Положение отдельных крючков можно менять по мере изменения операционного поля.

3 **Центральная рабочая зона**

Ретракционные элементы вынесены к периферии доступа.

Примеры применения в проктологии

По материалам клинической презентации Microcure

- **Геморроидэктомия**
- **Удаление анальных кондилом**
- **Операции при анальной трещине**
- **Трансанальное удаление опухолей**
- **Сфинктеропластика**

В исходной клинической презентации преимущество для проктологии сформулировано как стабильная экспозиция анального канала.

Доступные варианты исполнения в Российской Федерации

WZRR-A-C

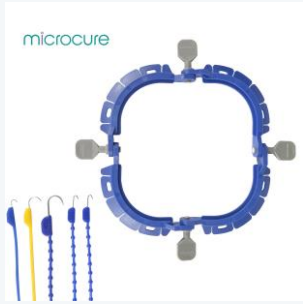

WZRR-A-D

WZRR-A-H

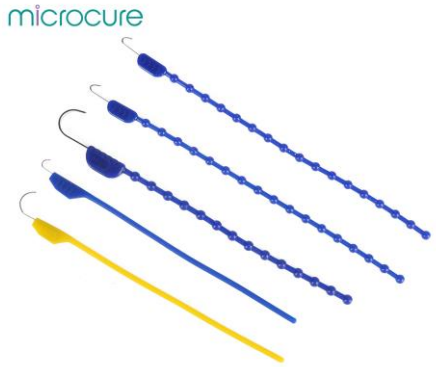

Ретракторные крючки

Зарегистрированные варианты крючков:

WZRR-P1-S-1 • WZRR-P1-L-1 • WZRR-P2-S-1
WZRR-P2-L-1 • WZRR-P3-L-1

Конкретный вариант кольца и крючков подбирается в зависимости от вида вмешательства и требуемого операционного доступа.

Одноразовая стерильная система

Кратность применения	однократное применение
Стерилизация	этиленоксид (ЕО)
Срок годности	2 года
Хранение и транспортирование	от +5 °С до +45 °С; относительная влажность не более 80%

Изделие не подлежит очистке или дезинфекции; техническое обслуживание и ремонт для изделия однократного применения не предусмотрены.

MICROCURE В РОССИИ

Одноразовая хирургическая ретракторная система

ООО «МЕДЛАЗЦЕНТР»

Официальный представитель Microcure в Российской Федерации

+7 (495) 668-12-91
medlaztiu@yandex.ru
retraktor.medlaz-center.ru
Москва, Ленинский пр-т, 131

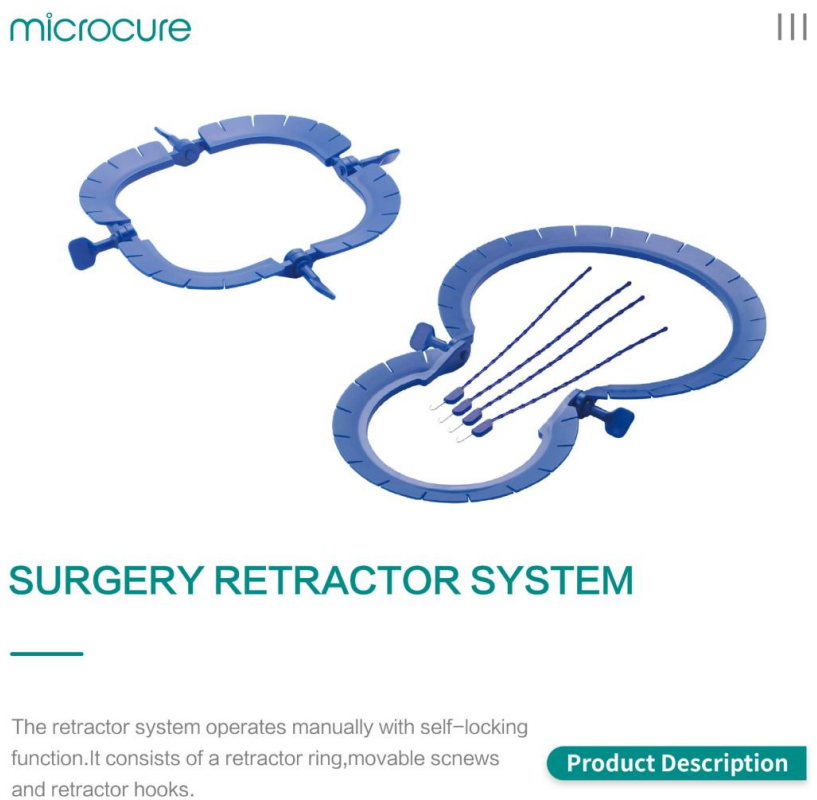

Информационный материал для медицинских специалистов.

Применение изделия — в соответствии с эксплуатационной документацией.